



Roche

Blutzuckermessen auf den Kopf gestellt

NEU

Accu-Chek® Guide:
Smart und einfach praktisch.

ACCU-CHEK®

Smarte Lösungen, die das Blutzuckermessen erleichtern



Messen bei Dunkelheit

Das neue Accu-Chek® Guide Blutzuckermessgerät besitzt ein helles Display sowie eine **Teststreifenbeleuchtung**.



Behutsames Stechen


Blutgewinnung mit nur einem Klick mit der Accu-Chek FastClix Stechhilfe.






Ergebnisse, auf die Sie sich verlassen können¹

Genauer als die heutige ISO-Norm verlangt*.

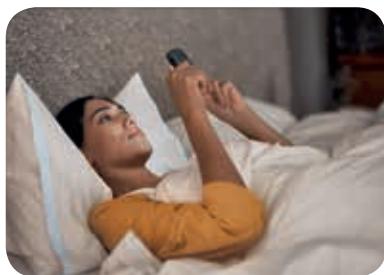

Ihre Daten – alle an einem Ort

Übersicht Ihrer Werte auf dem Smartphone – Zugriff über die Accu-Chek Connect App jederzeit und überall.

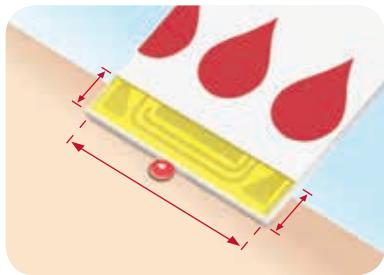

Schwer zu verfeheln

Tragen Sie **einen kleinen Blutstropfen an einer beliebigen Stelle** auf den gelben Rand der grossen und saugstarken Auftragsfläche auf.



Hygienischer Streifenauswurf

Dank des **Streifenauswurfsknopfes** genügt ein einziger Knopfdruck für einen schnellen und hygienischen Auswurf.


Durchführen einer Blutzuckermessung



Waschen Sie Ihre Hände mit warmem Wasser und Seife und trocknen Sie Ihre Hände gründlich ab.



Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum auf der Teststreifen-dose. Verwenden Sie keine Teststreifen, deren Haltbarkeitsdatum überschritten ist.



Schieben Sie **mit dem Daumen** einen Teststreifen mit leichtem Druck nach oben und entnehmen Sie ihn. Verschliessen Sie danach den Deckel wieder fest.



Führen Sie den Teststreifen in Pfeilrichtung ein. Das Gerät schaltet sich dadurch automatisch ein.



Berühren Sie mit dem gelben Rand des Teststreifens den Blutstropfen. Tragen Sie das Blut nicht auf die Oberseite des Teststreifens auf. Nehmen Sie den Finger vom Testfeld weg, sobald **Messung wird durchgeführt** auf dem Display erscheint.



Der Messwert erscheint innerhalb von 4 Sekunden. Falls Sie diesen Wert markieren möchten, drücken Sie die Taste **OK**. Ansonsten gehen Sie zu Schritt 8.



Drücken Sie auf die Taste **▼**, um die gewünschte Markierung auszuwählen. Drücken Sie auf **OK** um die Markierung dem Messwert hinzufügen.



Drücken Sie diese Taste um den Teststreifen aus dem Gerät auszuwerfen. Drücken Sie 3 Sekunden auf die Taste **OK** oder warten Sie 15 Sekunden: das Gerät schaltet sich aus.

Oft sind es die kleinen Dinge ...

... die Blutzuckermessen zu einem Problem machen. **Schnell den Teststreifen entnehmen wollen, unauffällig** bei ungünstigen Lichtverhältnissen messen, das kleine **Messfeld nicht treffen, die Messwerte per Hand notieren**, ... all dies kann eine echte Herausforderung bedeuten.

Das neue Accu-Chek® Guide System wurde entwickelt, um die Unannehmlichkeiten der täglichen Blutzuckermessung zu verringern – ob Sie auf dem Weg zu Arbeit sind, im Freien das Leben geniessen oder Zeit mit Ihrer Familie verbringen.



Accu-Chek® Guide

Smart und einfach praktisch.



Mehr über das smarte und einfach praktische Accu-Chek Guide System erfahren Sie auf www.accu-check.ch/guide.

08.089213.001 / 08-16 / 90000D

* 95% der mit drei Teststreifen-Chargen gemessenen individuellen Glukosewerte liegen bei Glukosekonzentrationen < 5,6 mmol/L (100 mg/dL) innerhalb $\pm 0,56 \text{ mmol/L}$ (10 mg/dL) und bei Glukosekonzentrationen $\geq 5,6 \text{ mmol/L}$ (100 mg/dL) innerhalb $\pm 10\%$ der mit der Referenzmethode des Herstellers gemessenen Werte.

1 Brazg RL, et al. New Generation Blood Glucose Monitoring System Exceeds International Accuracy Standards. J Diabetes Sci Technol. June 2016.

Experience what's possible.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK GUIDE, ACCU-CHEK FASTCLIX und ACCU-CHEK CONNECT sind Marken von Roche. © 2016 Roche

www.accu-check.ch

Roche Diabetes Care (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · 6343 Rotkreuz



ACCU-CHEK®